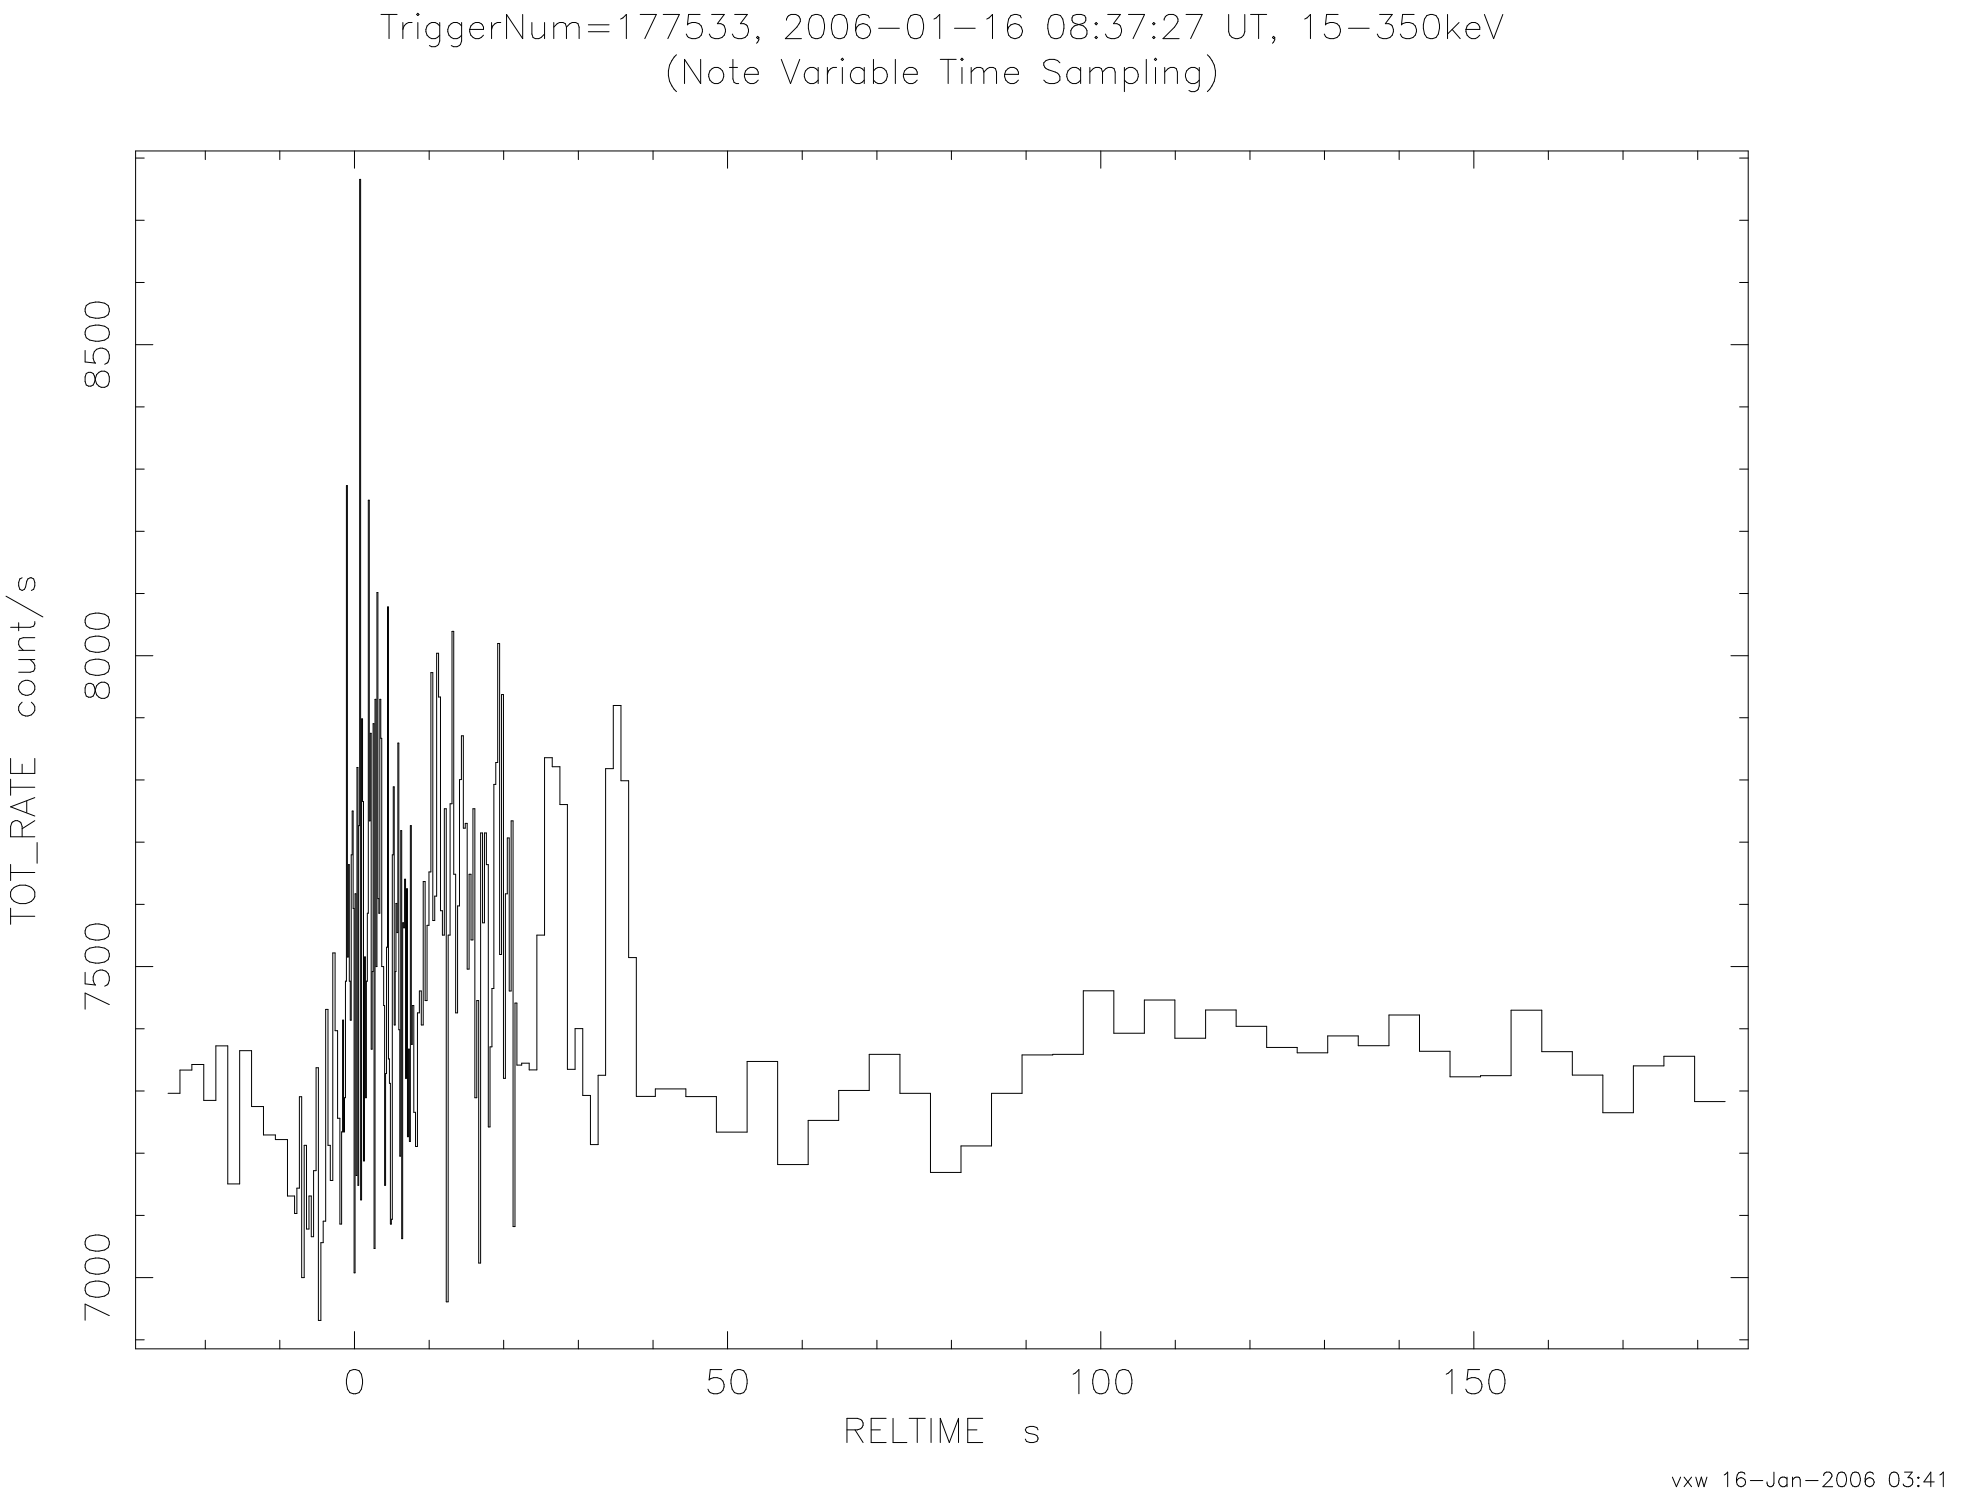
TriggerNum=177533, 2006-01-16 08:37:27 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
7500
8000
8500
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 16-Jan-2006 03:41