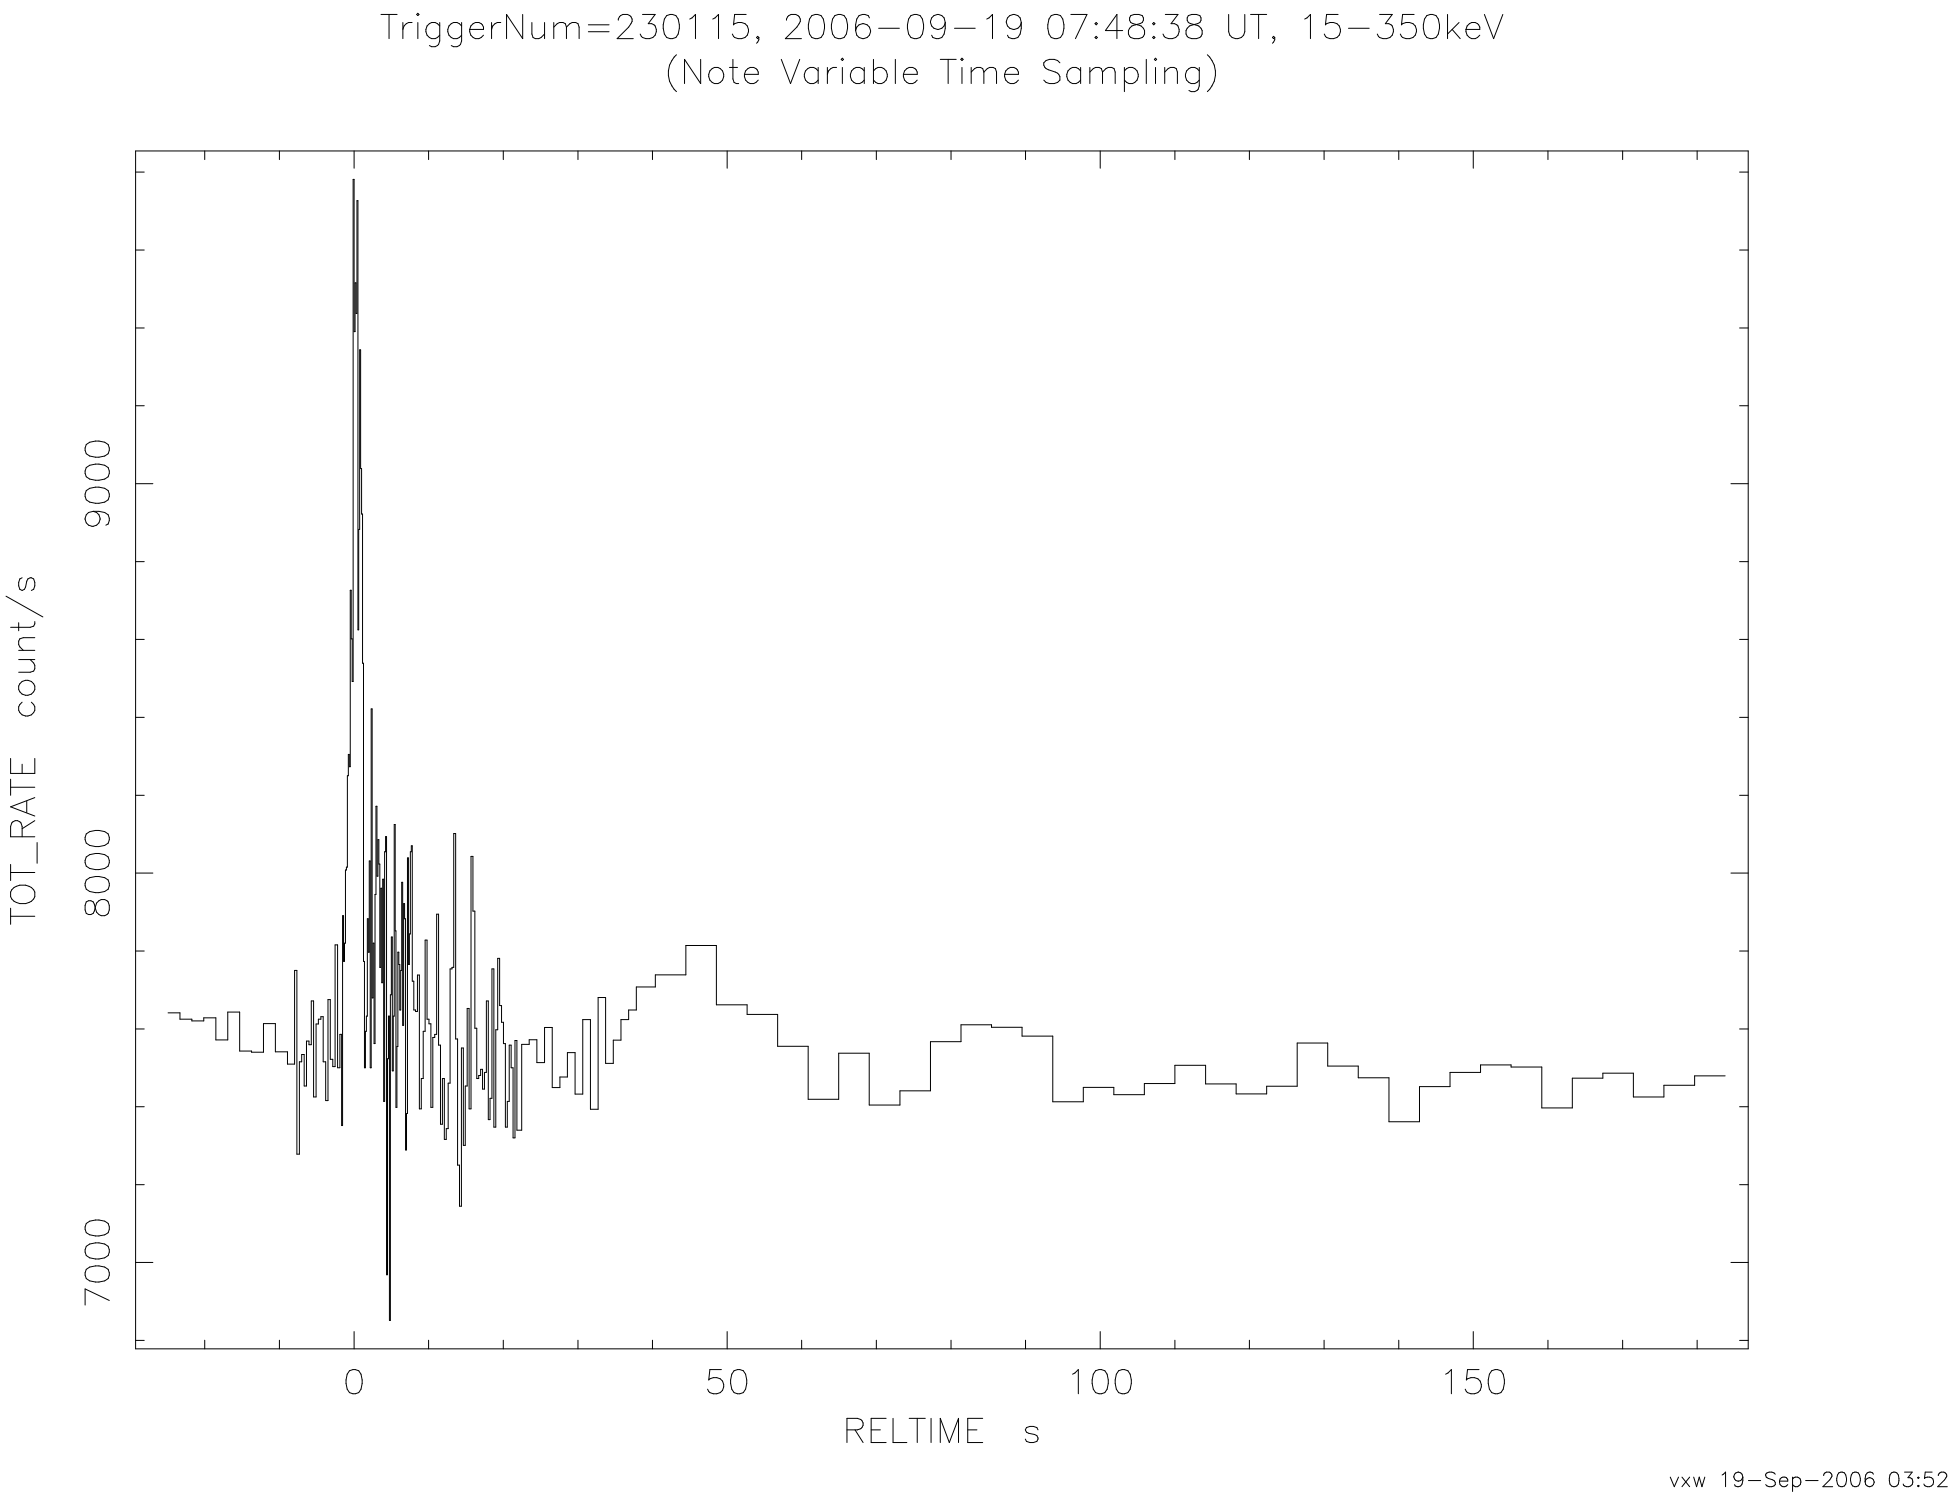
TriggerNum=230115, 2006-09-19 07:48:38 UT, 15-350keV
(Note Variable Time Sampling)
TOT_RATE count/s
7000
8000
9000
0
50
100
150
RELTIME s
vxw 19-Sep-2006 03:52